

Опросный лист для выбора массового кориолисового расходомера
Элметро-Фломак

Общая информация			
Предприятие-заказчик*		Эл. почта*	
Контактное лицо*		Количество*	
Город*		Позиция по проекту	
Телефон/Факс*		Дата заполнения*	

Информация об измеряемой среде			
Измеряемая среда*		Фазовое состояние*	
Плотность при 20С°		Наличие газа, % объм. в раб. услов.	

Характеристики рабочей среды:

☐ Агрессивная ☐ Склонность к налипаниям ☐ Абразивная до % твердых частиц

Информация о тех. процессе				
	миним.	ном.	макс.	ед. изм.
Расход в рабочих условиях*				
Давление среды, (изб.)*				
Плотность*				кг/м3
Температура среды*				С°
Вязкость*				

Система дозирования:

☐ Да ☐ Нет

Минимальная доза

Время прохождения дозы, сек

Допустимое падение давления на расходомере

Соединение с трубопроводом			
Внутрен. диаметр, мм*		Стандарт фланцев	
Толщина стенки, мм*		Ответные фланцы в комплекте	Нет
Материал*	Ст.20	Форма уплот. поверх. фланцев	
Монт. вставка (катушка)	Нет	Межфланцевое расстояние, мм	
Другое			

Требования к исполнению расходомера	
Погрешность измерения массового расхода жидкости, %*	
Погрешность измерения массового расхода газа, %	
Абсолютная погрешность измерения плотности, кг/м3	2 (рекоменд)
Питание расходомера	20...36В ВС (только комп. исп.)
Графический индикатор/сенсорная клавиатура	Нет (только комп. исп.)
Конструктивное исполнение расходомера (см. рис. ниже)	Интегральное
Исполнение электронного блока (с диплеем), ГОСТ 14524-2015	IP65 (по умолчанию)
Стойкость элект. блока к возд. сероводорода в окруж. среде	Нет
Длина технологического кабеля, м (см. рис. ниже)	
Защита технолог. кабеля	Небронированный
Кабельный ввод №1 для подкл. вторичной аппаратуры	Да
Кабельный ввод №2 для подкл. вторичной аппаратуры	Да


Кабельный ввод под кабель

внутр. диаметр кабеля	внешн. диаметр кабеля


Температура окружающей среды, С°

миним.	макс.


* Замечание.
Пункты обозначенные знаком *, обязательны для заполнения.
Заполненный опросный лист отправить на электронную почту
KIP@teplobor.net.

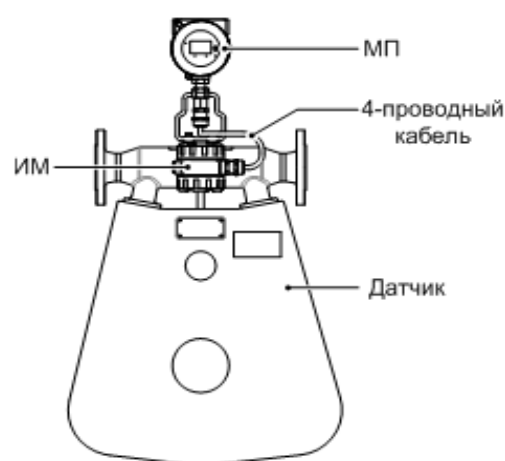

Интегральное (длина кабеля 0.5м)

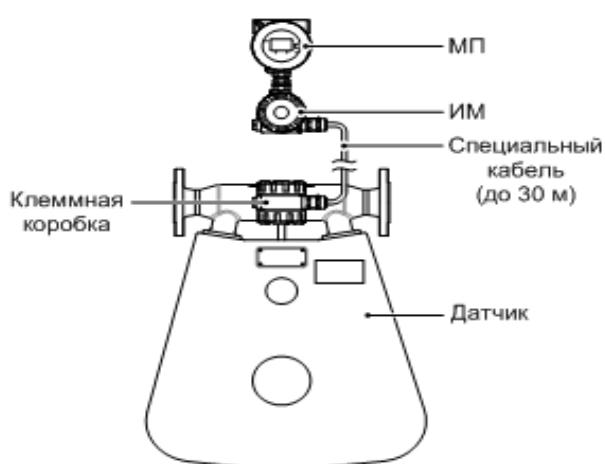


Раздельное (длина кабеля до 30м)

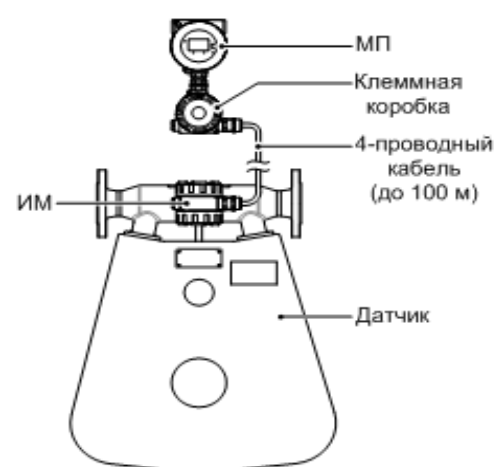

Выносное (длина кабеля до 100м)



Раздельно-выносное (длина кабеля до 130м)

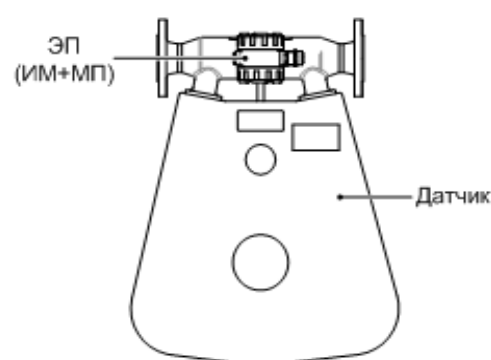

Компактное (без кабеля и дисплея)

Взрывозащита

Категория газовой смеси по месту установки расходомера	IIA
Категория взрывоопасной зоны по месту установки расходомера	B-I

Входные/выходные сигналы

	Да/Нет	шт.
4-20mA выход (пассивный)	Нет	
HART v.5/V.7		
частотный выход (пассивный)		
импульсный выход (пассивный)		
дискретный выход (пассивный)		
дискретный вход		
RS-485 (Modbus RTU)		

Дополнительные требования

Наличие термочехла:

☐ Да ☐ Нет

Наличие датчика давления:

☐ Да ☐ Нет

Наличие HART-модема:

☐ Да ☐ Нет

Другое	
--------	--

Примечания

* Замечание.

Пункты обозначенные знаком *, обязательны для заполнения.

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту

KIP@teplotribor.net.