


Коды заказа для взрывозащищенного исполнения

Регистратор видеографический Элметро-ВиЭР

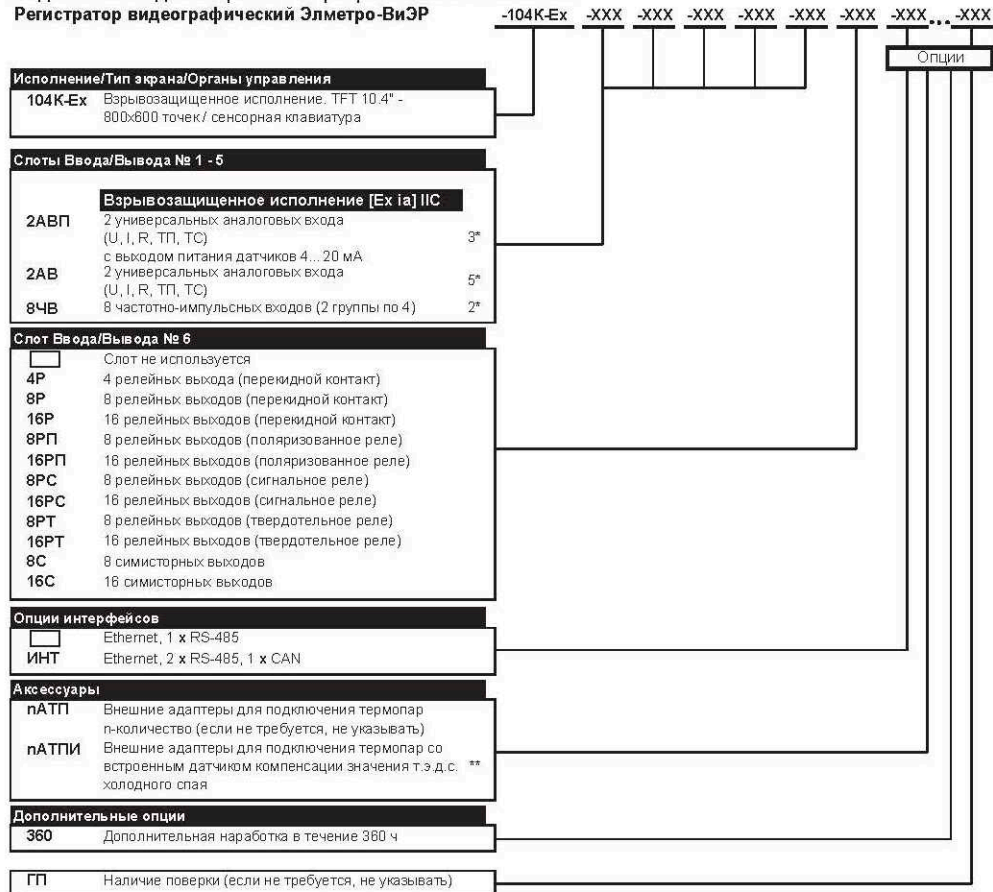

Примечания

* - Максимальное количество плат данного типа в приборе
 При одновременном использовании слотов разного типа максимальное количество слотов АВ и/или ЧВ должно соответствовать формуле АВ (ЧВ) = 2 * (3 - АВП), но не более их максимального количества.

** - в стандартной комплектации с каналами АВ(П) всегда имеется 1 адаптер для подключения термопар АТПИ (с встроенным датчиком РТ100 компенсации т.э.д.с. холодного спая). Номер измерительного канала АВ(П), к которому он подключен, конфигурируется.

Возможно изменение конфигурации прибора по спецификации заказчика (по согласованию)

Примеры заказа прибора

Регистратор видеографический Элметро-ВиЭР - 104K-Ex - 2ABП - 2ABП - 2ABП - 16Р

Регистратор видеографический Элметро-ВиЭР - 104K-Ex - 2AB - 2AB - 2ABП - 2ABП - 8РП - ИНТ